



ENG

1 Install the included batteries into your scale.

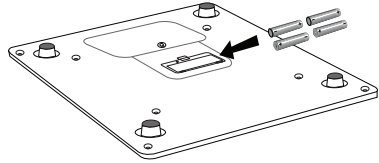

2 To change the units, push and release the set switch. Default is lb.

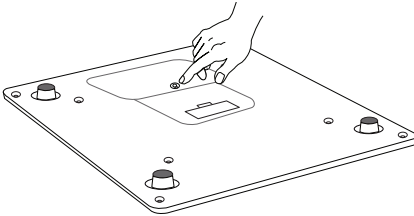

3 Turn on *Bluetooth*<sup>®</sup> settings on your mobile device (smartphone or tablet).

4 Download the free **A&D Heart Track** app from the App Store or Google Play.




## 5 Getting started with **A&D Heart Track** app.


5a. Set up account. Create a username and password.




5b. Select Menu.



5c. Click Add *Bluetooth*® Devices.



5d. Click **+** and select scale.





5e. Select UC-352BLE.



5f. Complete the pairing process.


Press and hold the button.

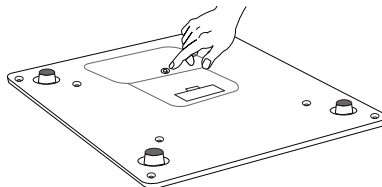


5g. The scale displays “**End**” to indicate pairing is complete.




5h. Click **+** at the bottom.



5i. Select **Weight**. Select **Auto Bluetooth®**.

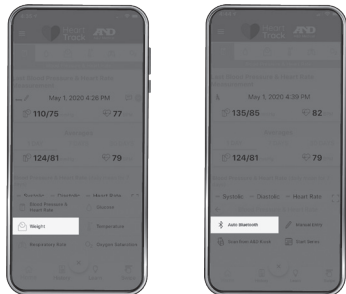


6 The scale is now ready to be used. Step on the scale to take a reading.

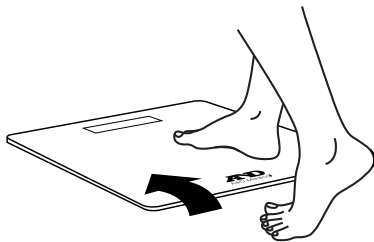

7 Stay on the scale until “**STEP**” and “**off**” are alternately displayed.



8 Step off the scale.

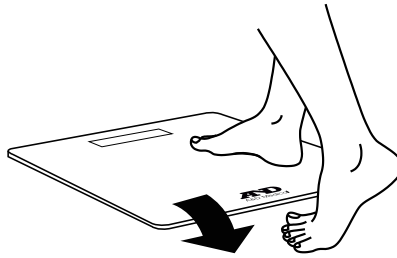

9 See your weight. Measurements are sent to your mobile device. When the A&D Heart Track app is open and running. Results are stored in the scale when your mobile device is not available.



A&D Medical



1-888-726-9966 | [andmedical.com](http://andmedical.com)

©2021A&D Medical. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. iPad, iPhone and iPod are trademarks of Apple, Inc. Android and Google play are trademarks of Google, Inc. Specifications subject to change without notice.  
UC-352BLE-QSG


1WDEK4006332A

ESP

1 Coloque las pilas suministradas en el bascula.

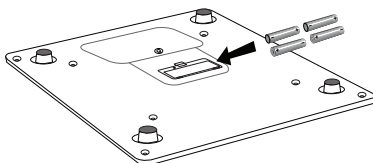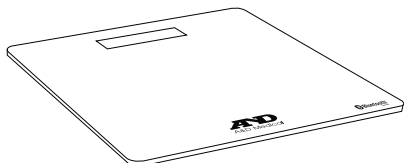

2 Para cambiar las unidades, presione y suelte el interruptor de ajuste. Valor predeterminado en lbs.

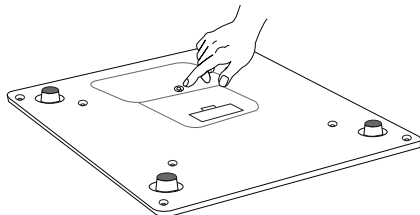

3 Encienda sus ajustes de *Bluetooth*® en su aparato móvil. (tableta o smartpone).

4 Para conectarlo a su dispositivo descargue e instale "A&D Connect" app.



## 5 Introducción a la aplicación **A&D Heart Track**.

5a. Configure la cuenta.  
Cree un nombre de usuario y contraseña.



5b. Seleccione el menú.



5c. Haga clic en Agregar dispositivos **Bluetooth**®.



5d. Haga clic en **+** y seleccione el bascula.





5e. Seleccione UC-352BLE.




5f. Complete el proceso de emparejamiento.


Pulse y mantenga pulsado el botón **START**.

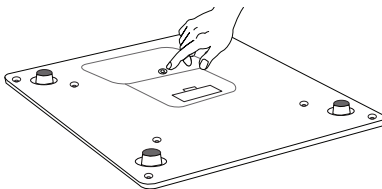


5g. El bascula muestra “**End**” para indicar que el enlace se ha completado.

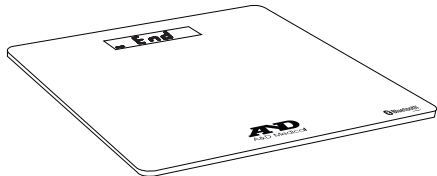


5h. Haga clic en **+** en la parte inferior.



5i. Seleccione **bascula**.  
Seleccione **Bluetooth®** automático.




6 Párese en el bascula para pesarse.

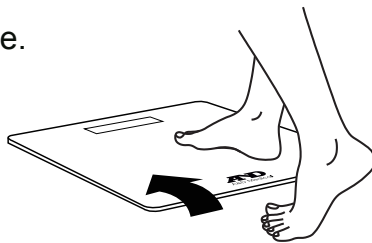

7 Permanezca en el bascula hasta que aparezcan de manera alternada “**StEP**” (Paso) y “**off**” (apagado).



8 Bájese de el bascula.

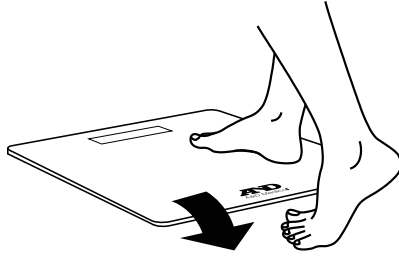

9 Fíjese cuánto pesa. Las mediciones se envían a su dispositivo móvil. Cuando la aplicación de A&D está abierta y funcionando. Los resultados serán guardados en la memoria cuando su aparato móvil no esté disponible.



**A&D**  
A&D Medical

1-888-726-9966 | [andmedical.com](http://andmedical.com)

©2021 A&D Medical. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios. iPad, iPhone e iPod son marcas comerciales de Apple, Inc. Android y Google play son marcas comerciales de Google, Inc. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. UC-352BLE-QSG

1WDEK4006332A